
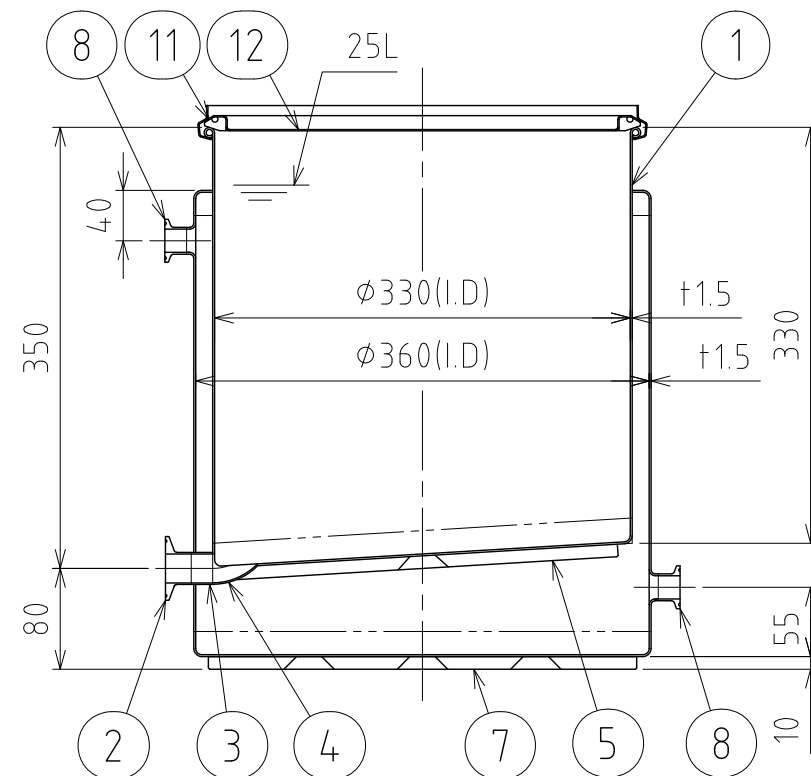
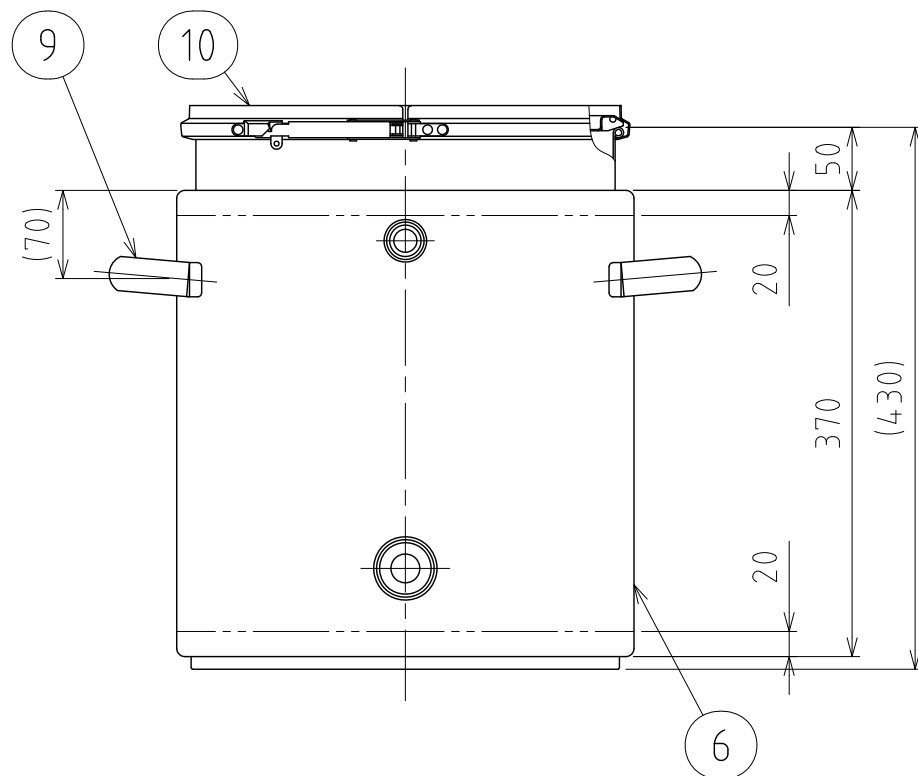


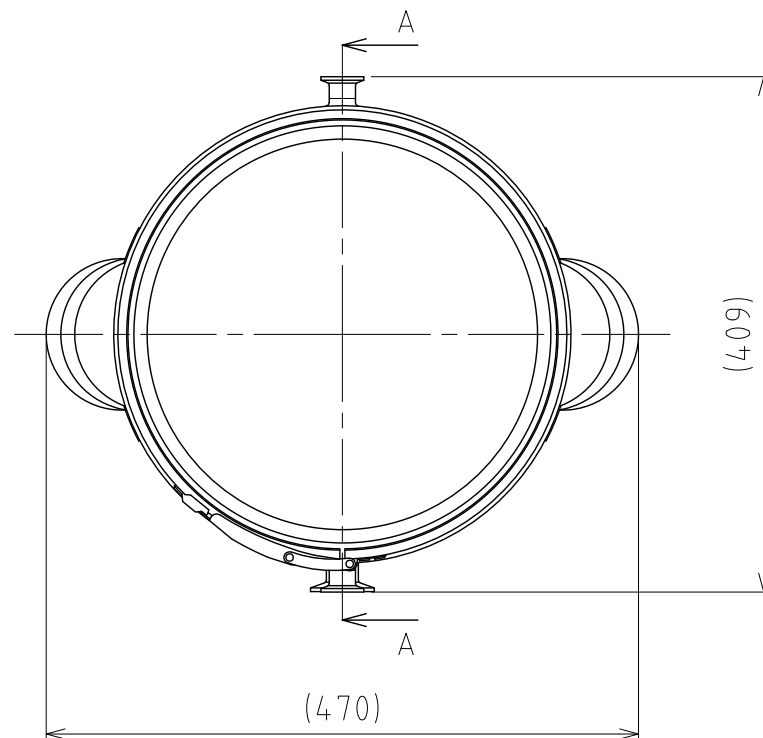

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ 23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ 23(I.D) × L17	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ 23(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ 310× t10	SUS304	1	3-0000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板 (B)	φ 340× t10	SUS304	1	3-0000000-0
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
9	取っ手	M	SUS304	2	
10	レバーバンド	B-33	SUS304	1	
11	ガスケット	LP-33	シリコンゴム	1	
12	密閉蓋	L-33 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 25L

ジャケット 約12.1L(上部ヘルールまで)

ジャケツト使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

補強板(A)(B)の取付は外周断続溶接、丸穴部全周溶接

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

8

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型スローブ容器 KTPJ-CTL-33		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041520-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				