File #	040206-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R180×R18	SUS304	1	鏡板：4-005038
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005052
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D)×L10	SUS304	1	
4	ジャケット		SUS304	1	
5	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
6	取っ手	S	SUS304	2	
7	キャッチクリップ		SUS304	3	
8	ガスケット	MPA-18	シリコンゴム	1	
9	密閉蓋	M-18 (t0.8)	SUS304	1	

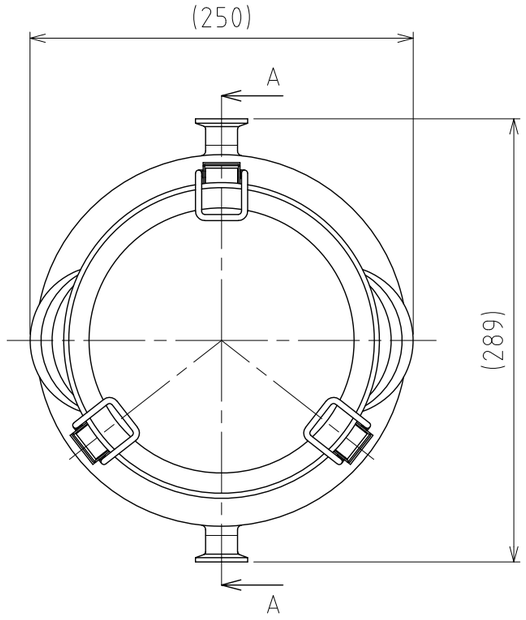

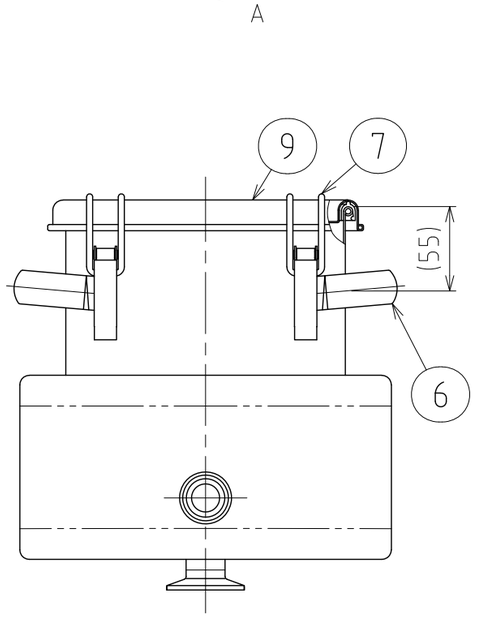

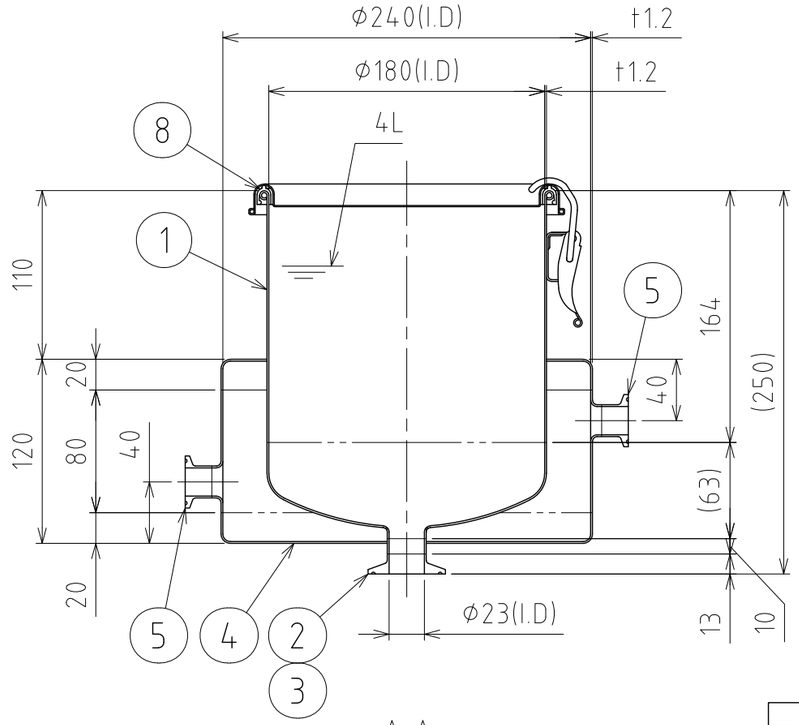

A-A

注記
容量：容器本体 4L
ジャケット 約2.1L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

DESIGN	DATE
	2016/03/31
DRAWN	DATE
CHECKED	DATE
APPROVED	DATE

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型鏡板容器（ヘルール接続型） DTFJ-CTH-18		
DWG NO.	3-040206-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp