
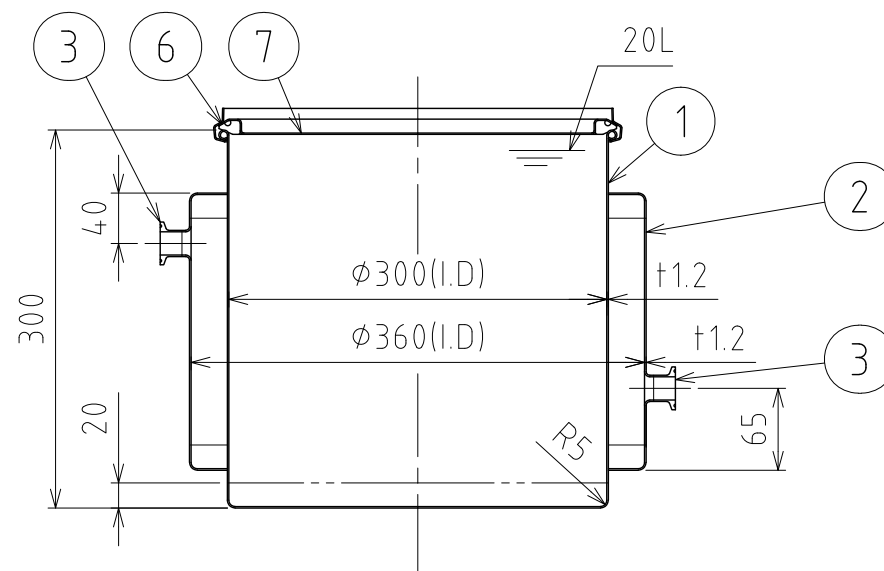
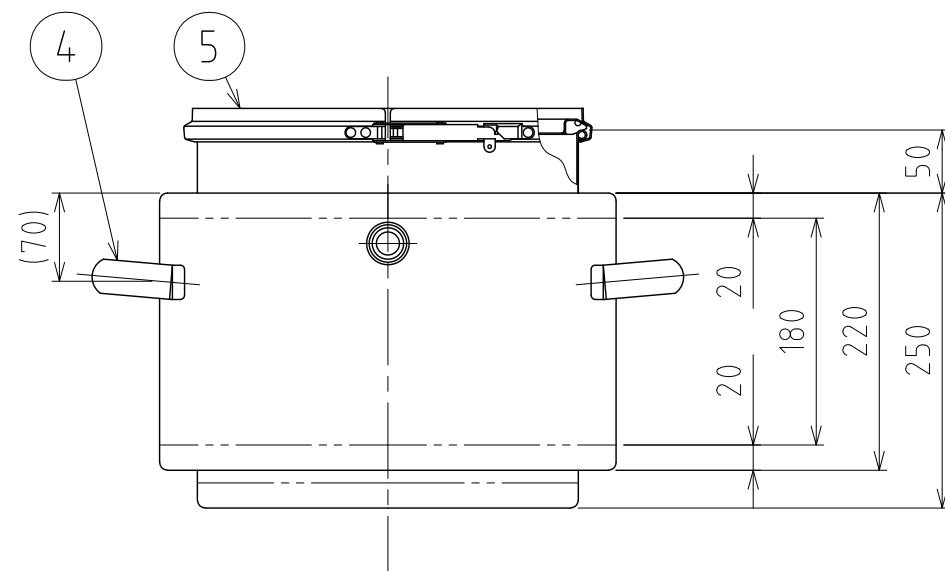


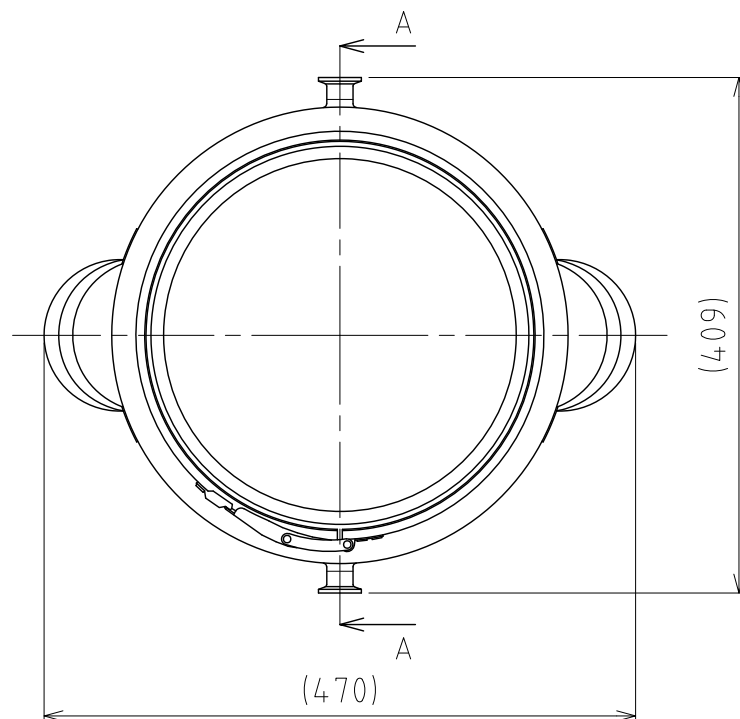

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ジャケッ ト		SUS304	1	
3	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	4-005203
4	取っ手	M	SUS304	2	
5	レバーバンド	B-30	SUS304	1	
6	ガスケット	LP-30	シリコンゴム	1	
7	密閉蓋	L-30 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約5.5L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨


取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型フラット容器 F T J - C T L - 3 0 (S)		
	2018/07/27				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 0 3 7 6 4 - 0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:6	CUSTOMER	
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			